



Схема электрическая принципиальная
приложения 4 к Т0 ВЗ-57

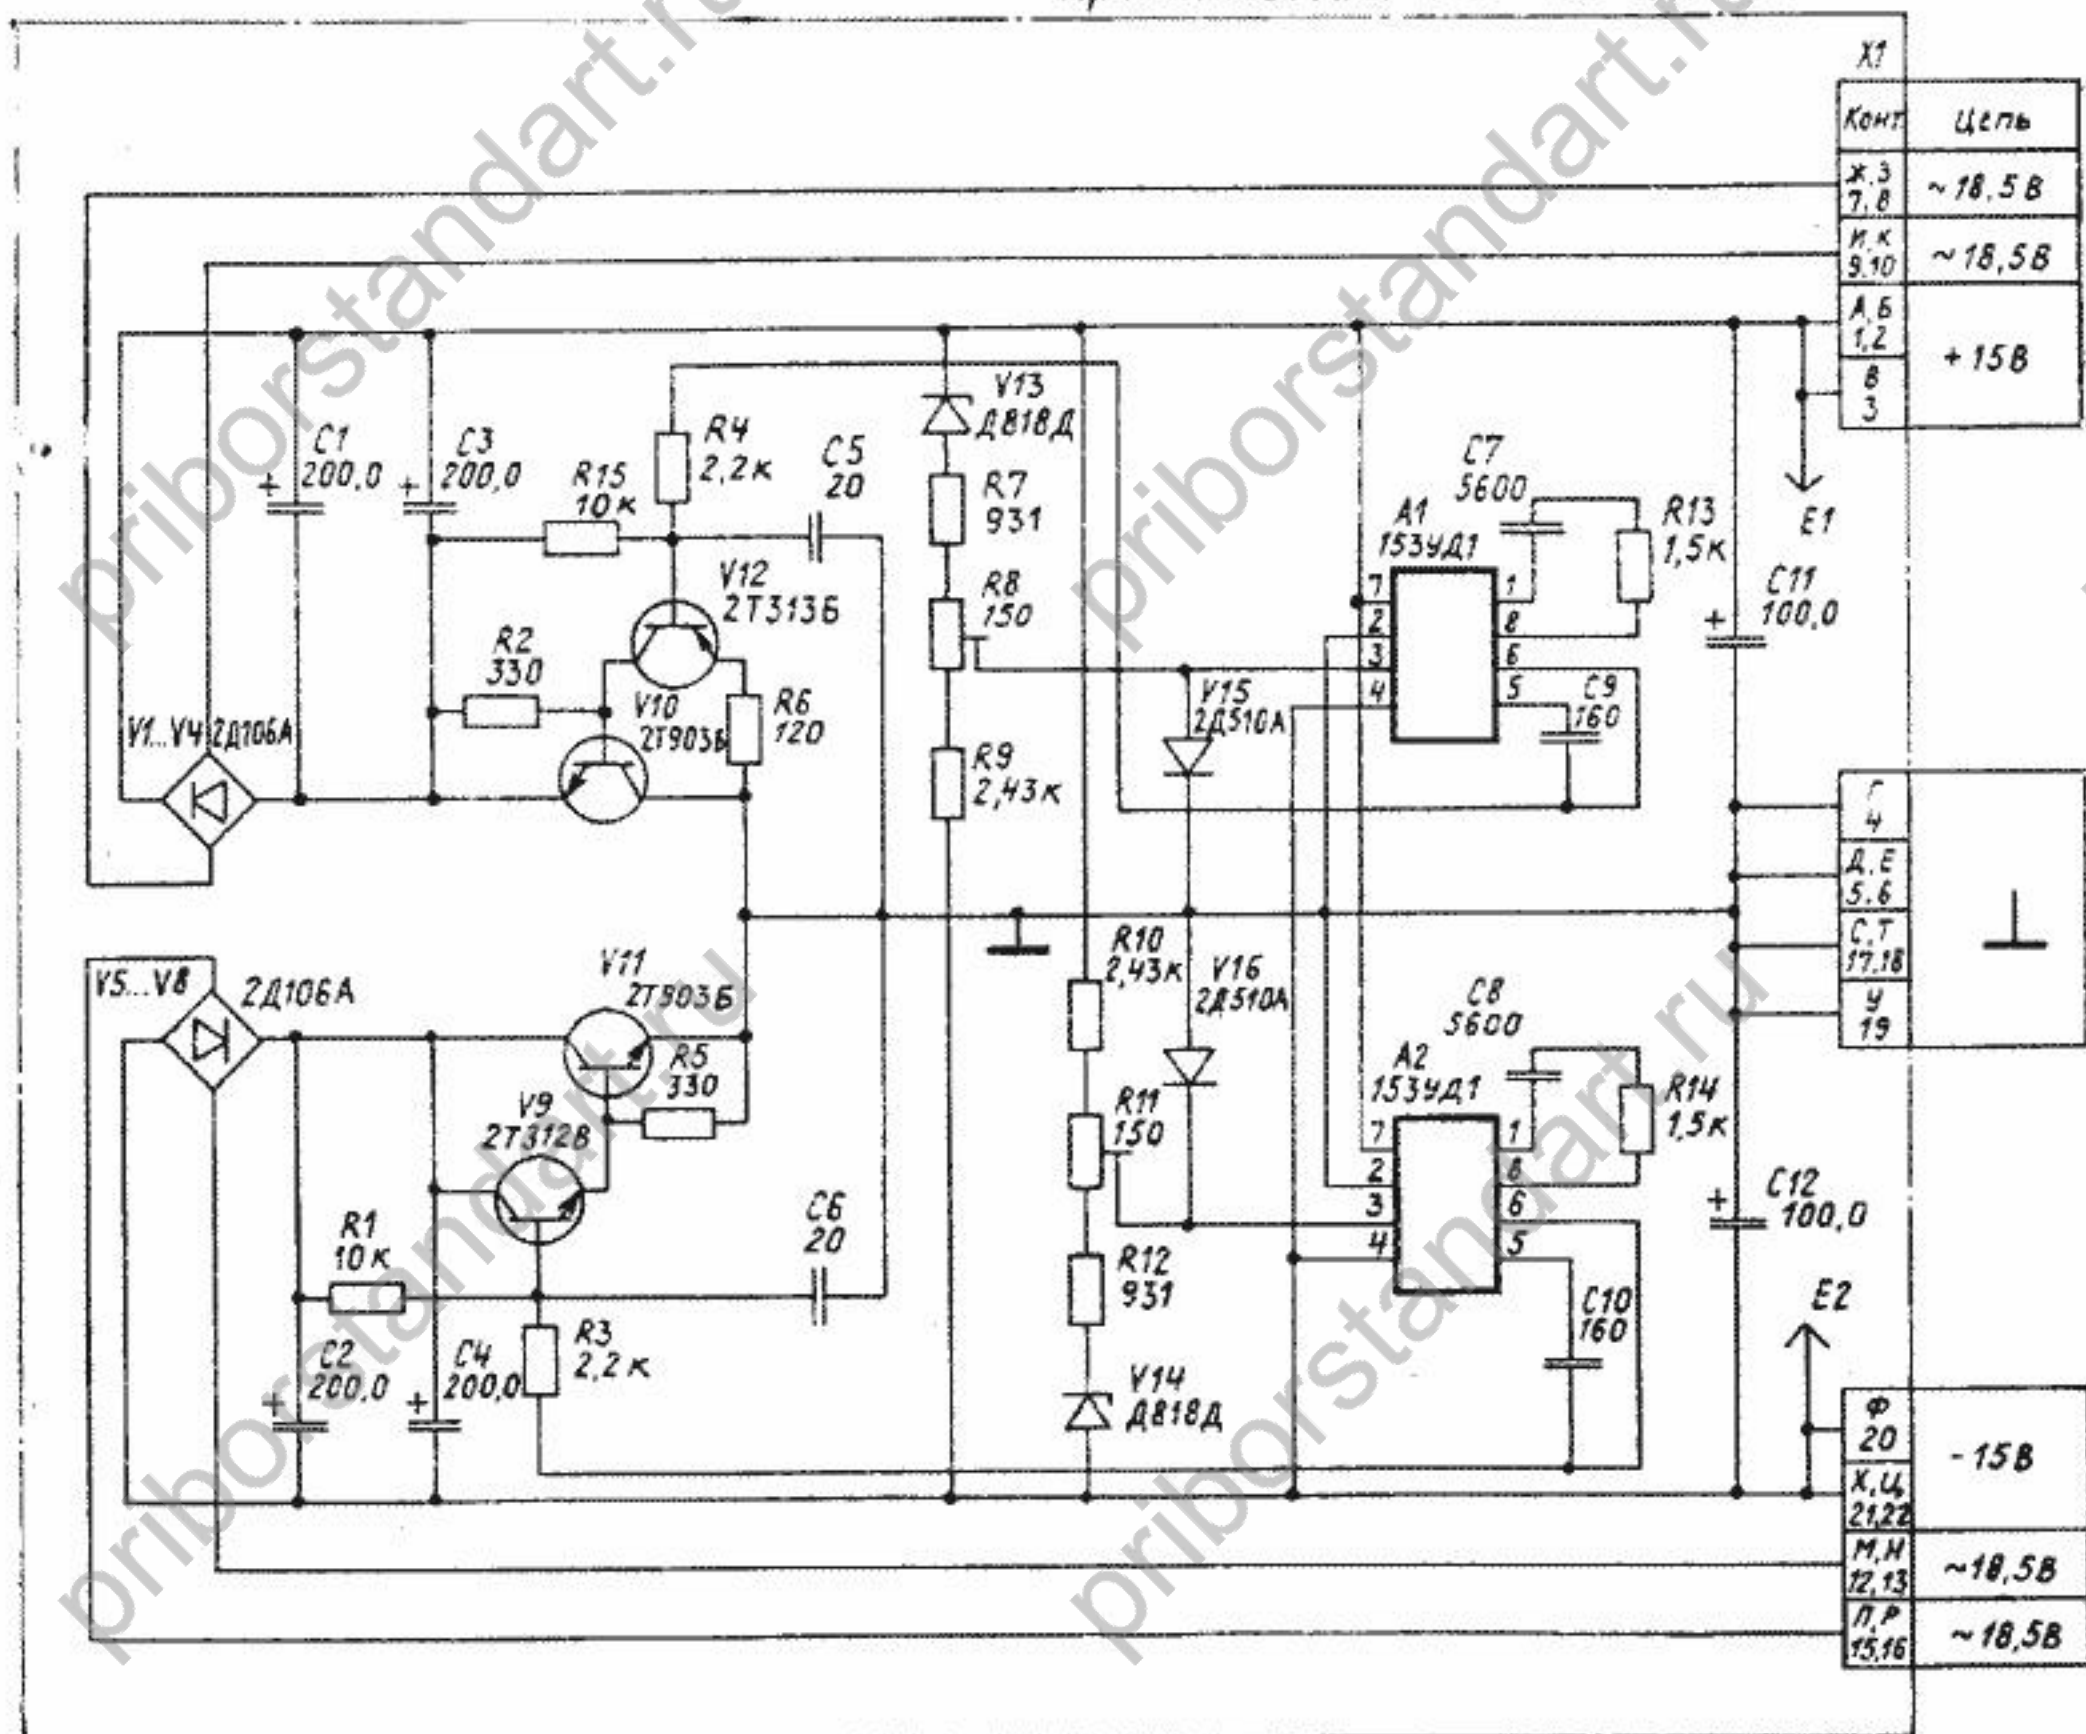


Е - контрольная точка

Стабилизатор

Микровольтметр ВЗ-57

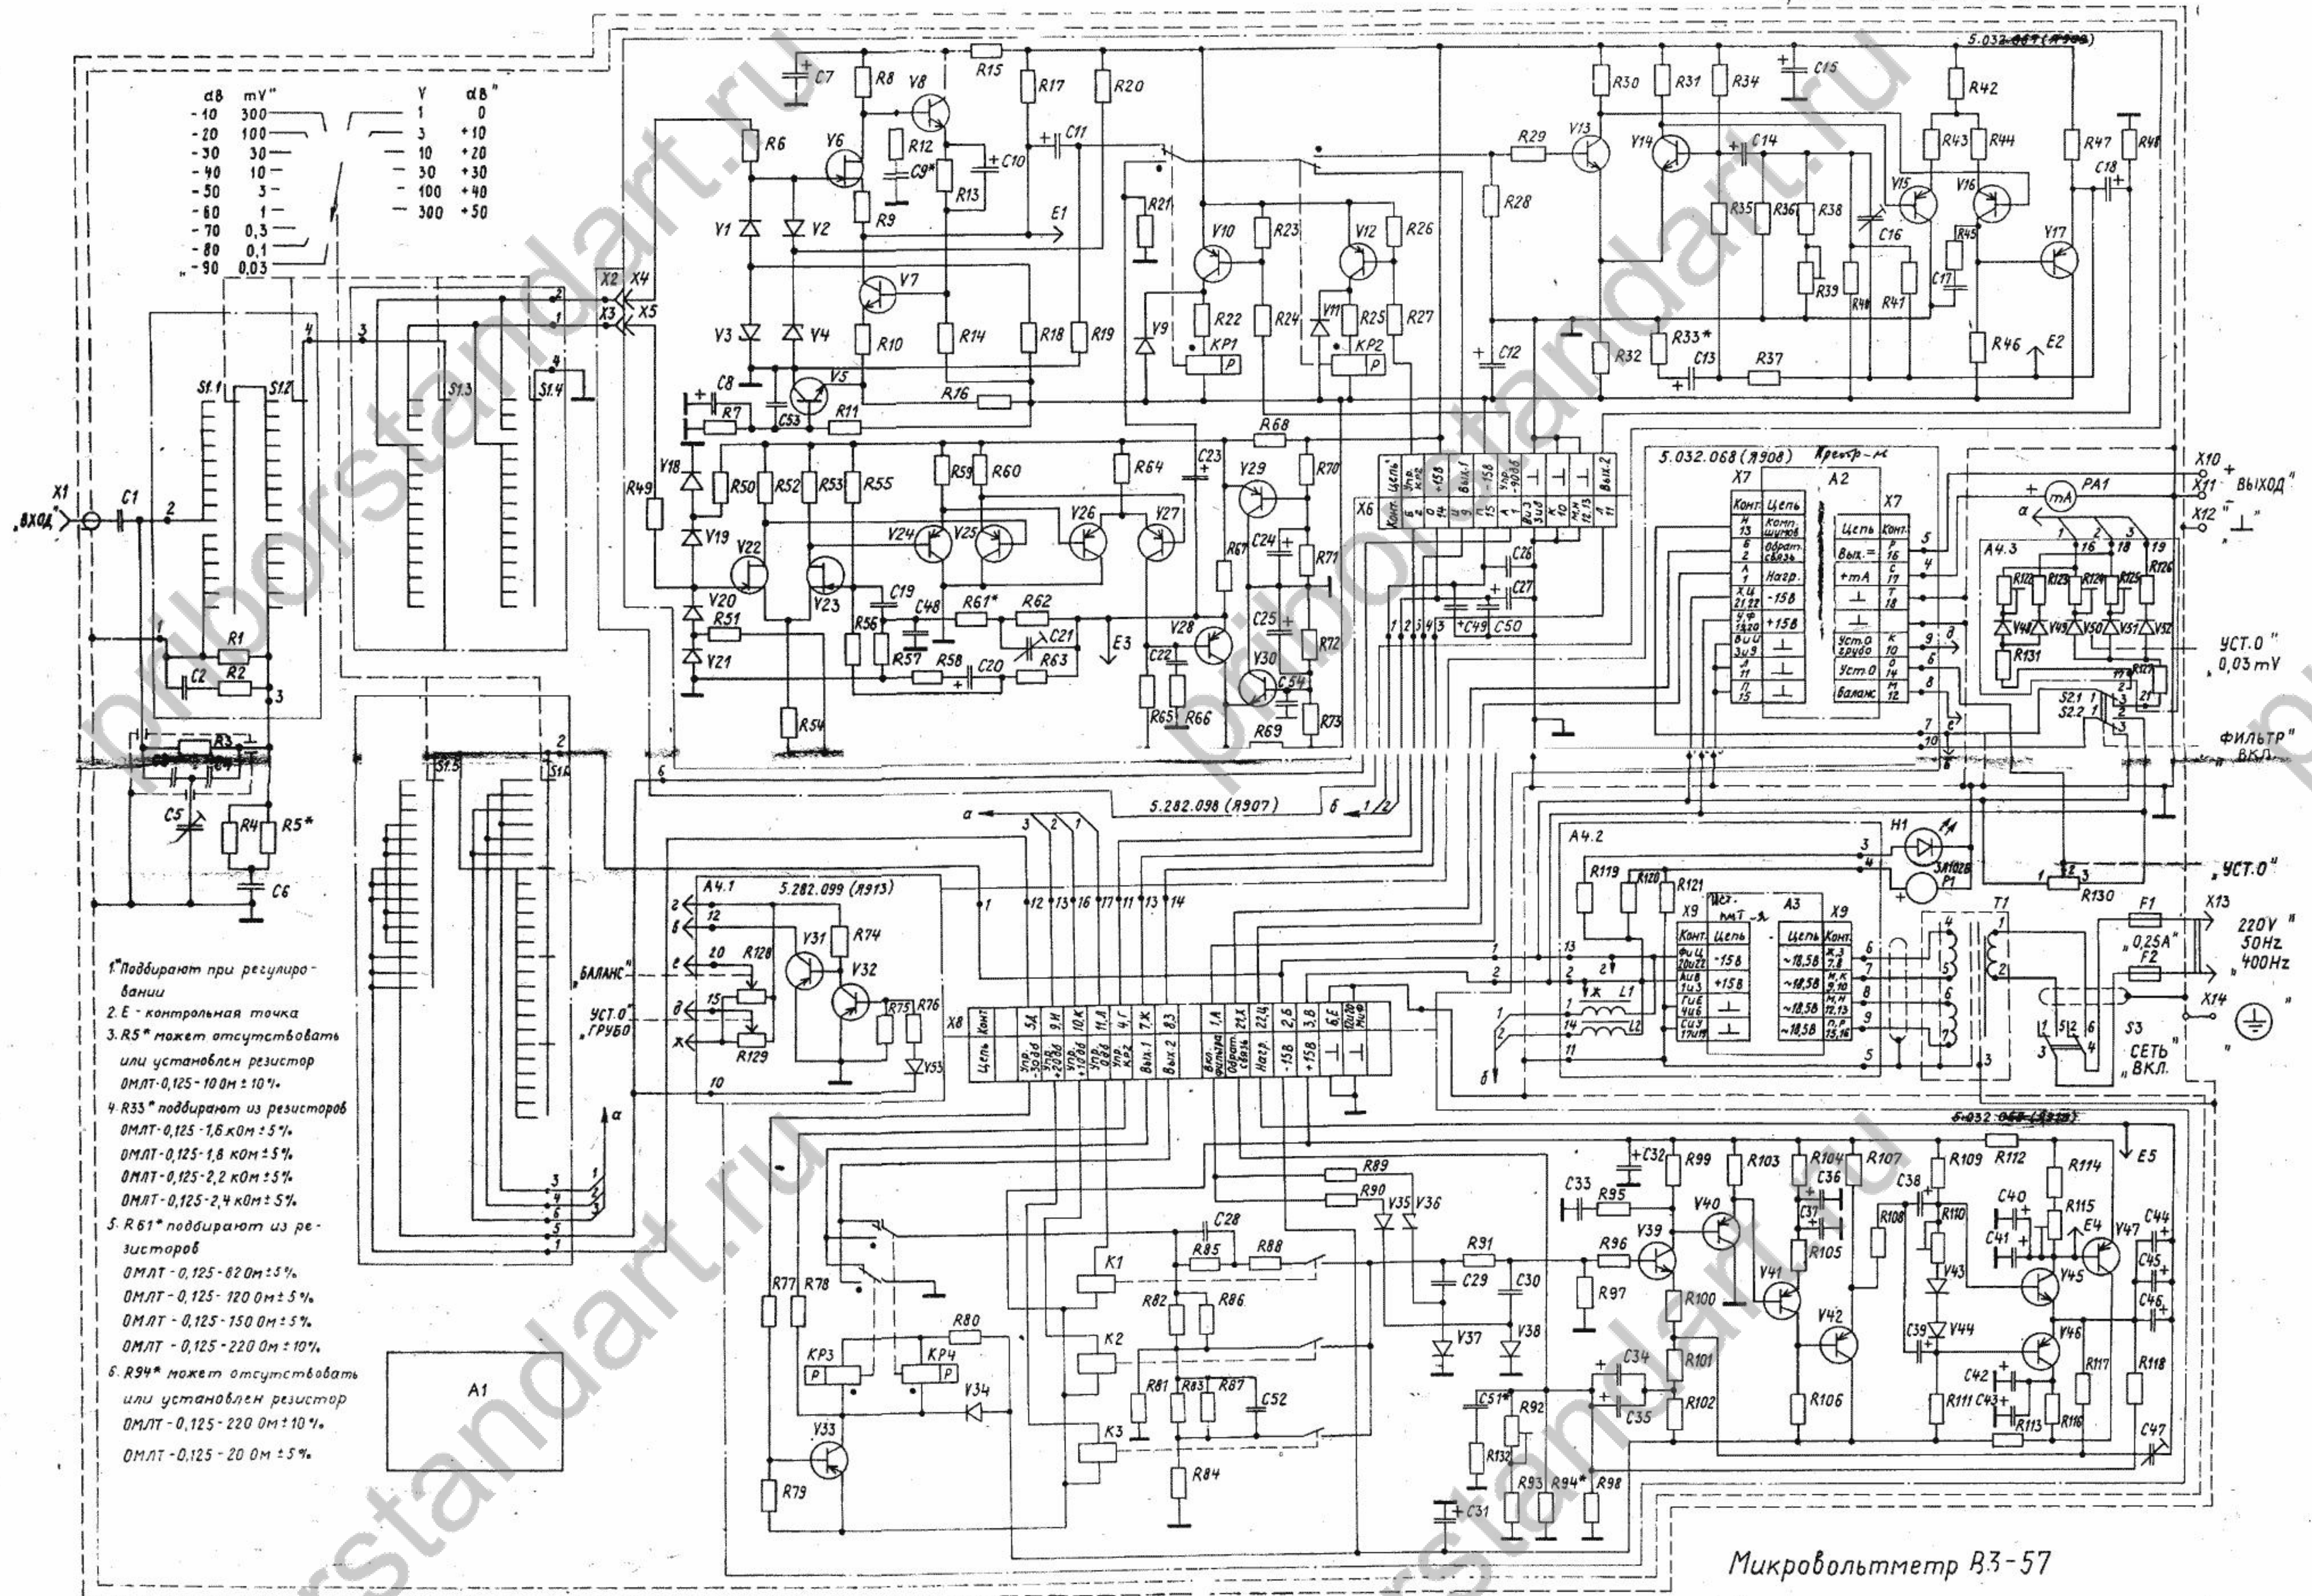

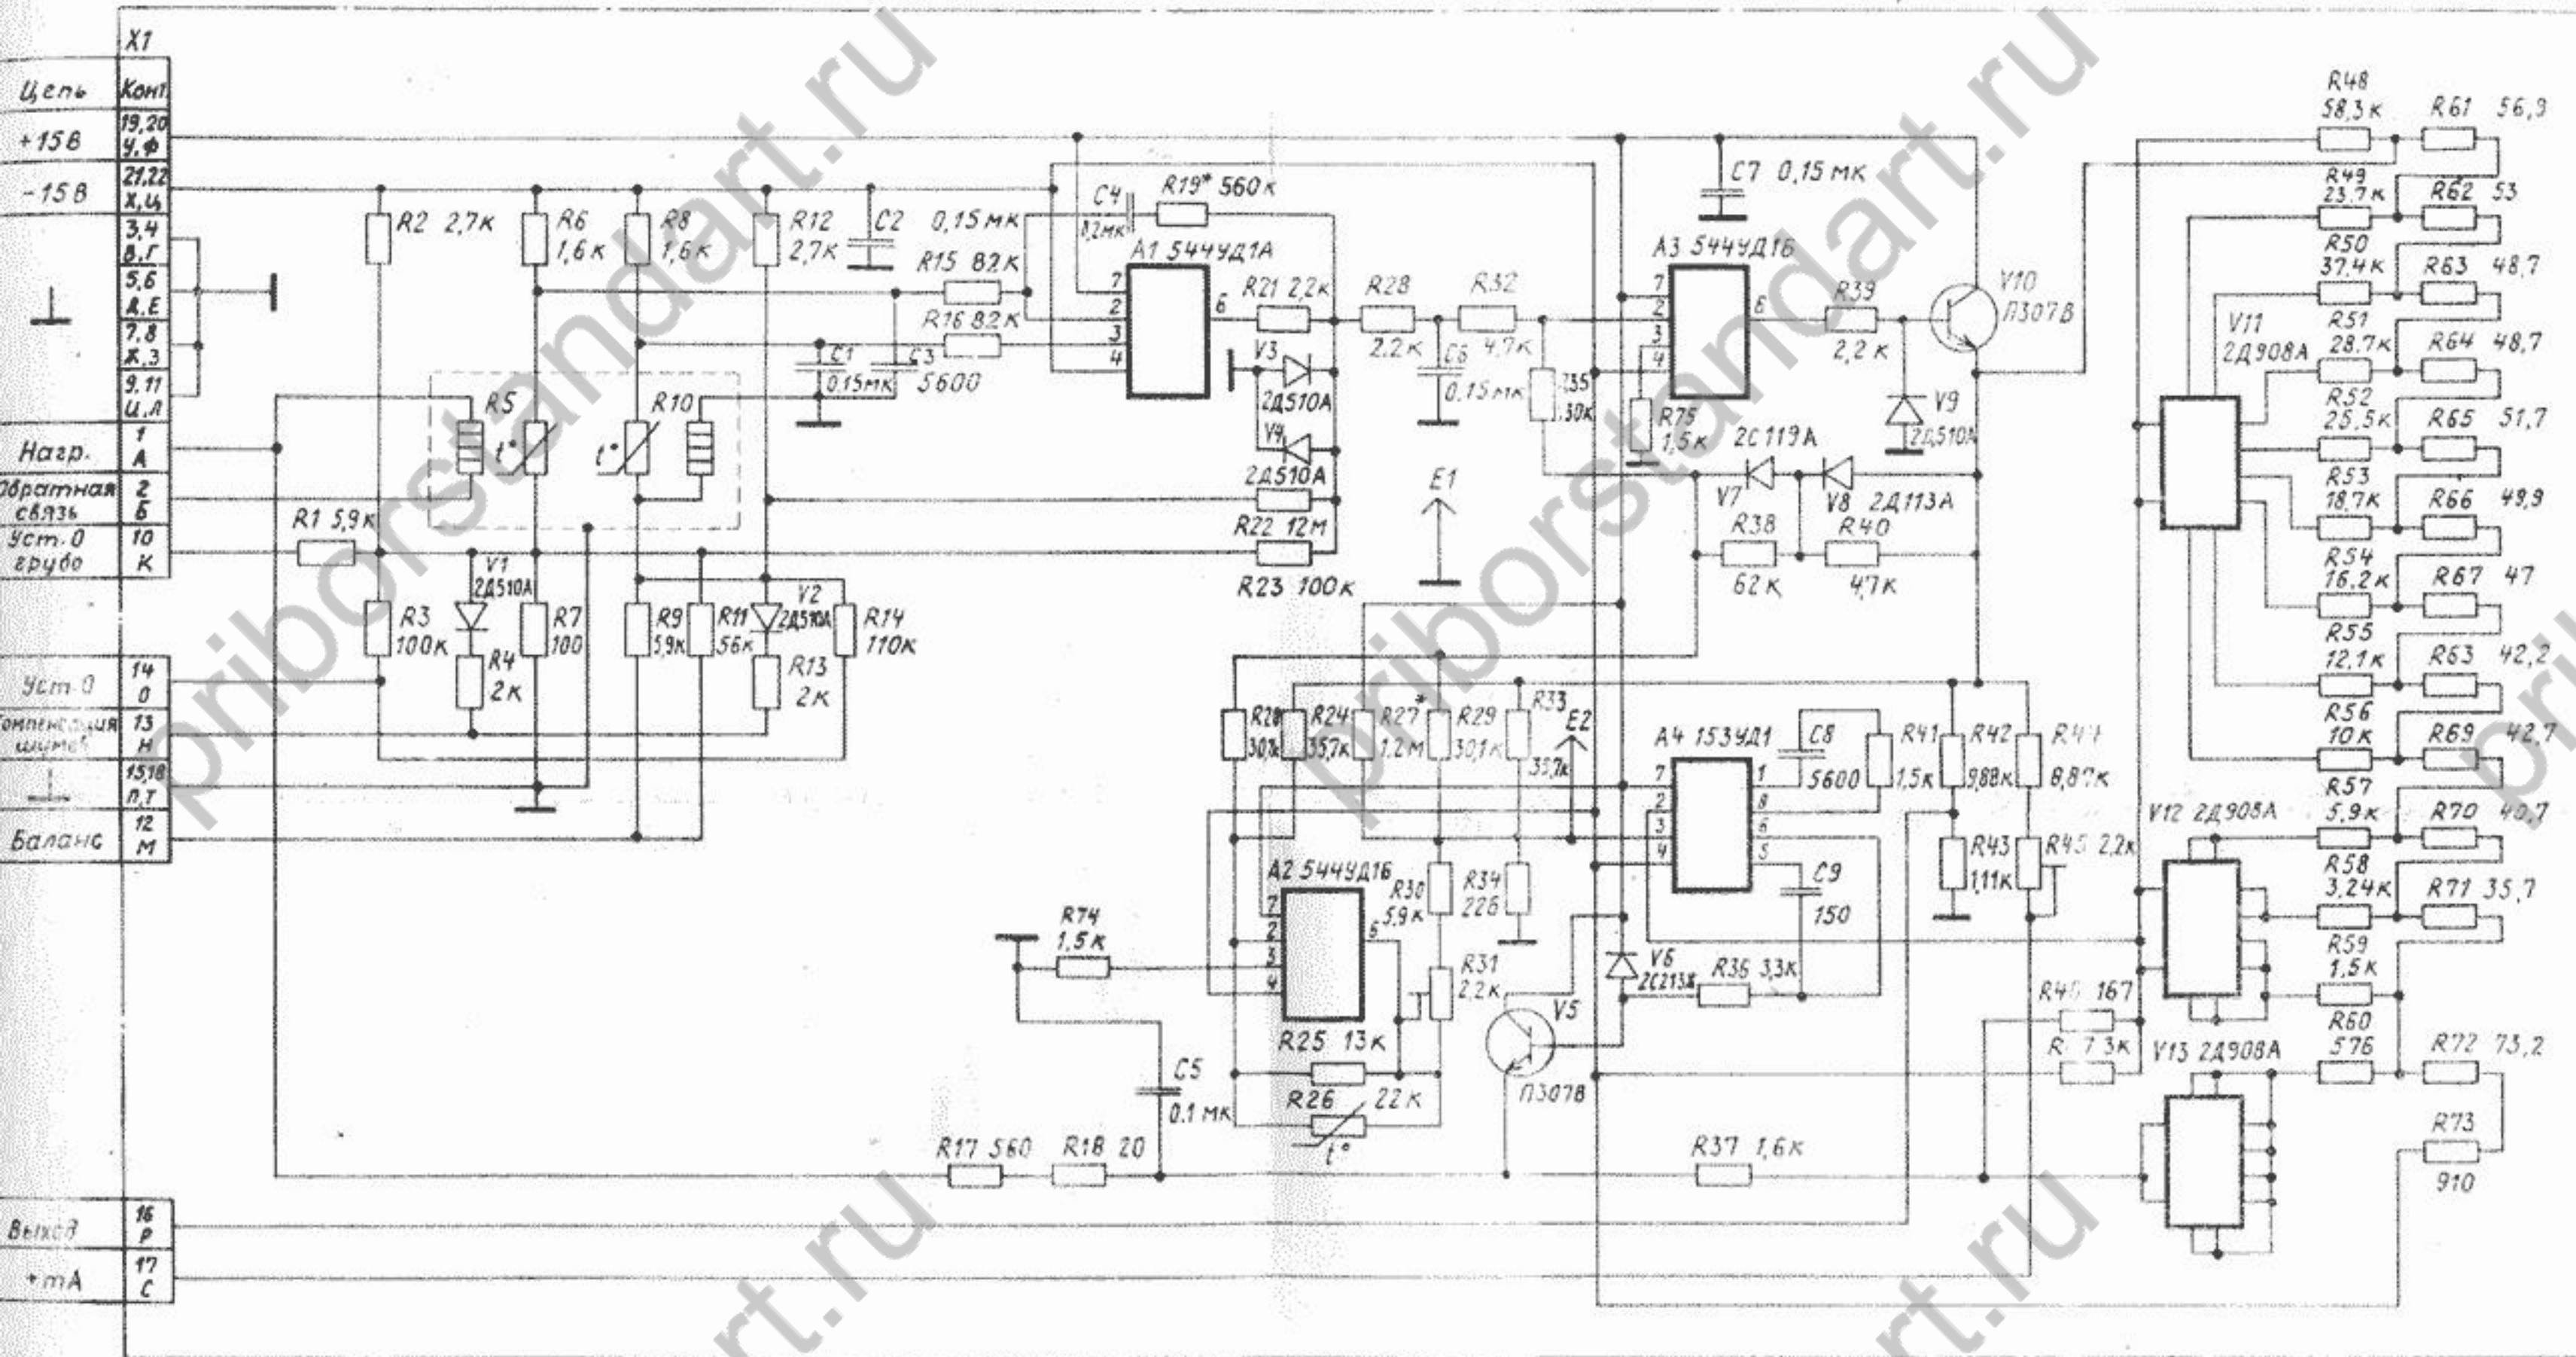

3 1669

- 1* Подбирают при регулировании.
2. E - контрольная точка
3. R27* может отсутствовать или установлен резистор 0МЛТ-0,25 - 390 кОм ± 10%. R27* установить на лепестки, ведущие к контактам 19 или 21 вставки разъемной X1.

Преобразователь